



织废气
华正检
HUAZHENG TES
E-mail：hz@hztesting.co
WUHAN HUAZHENG TE
Tel：027-87968599

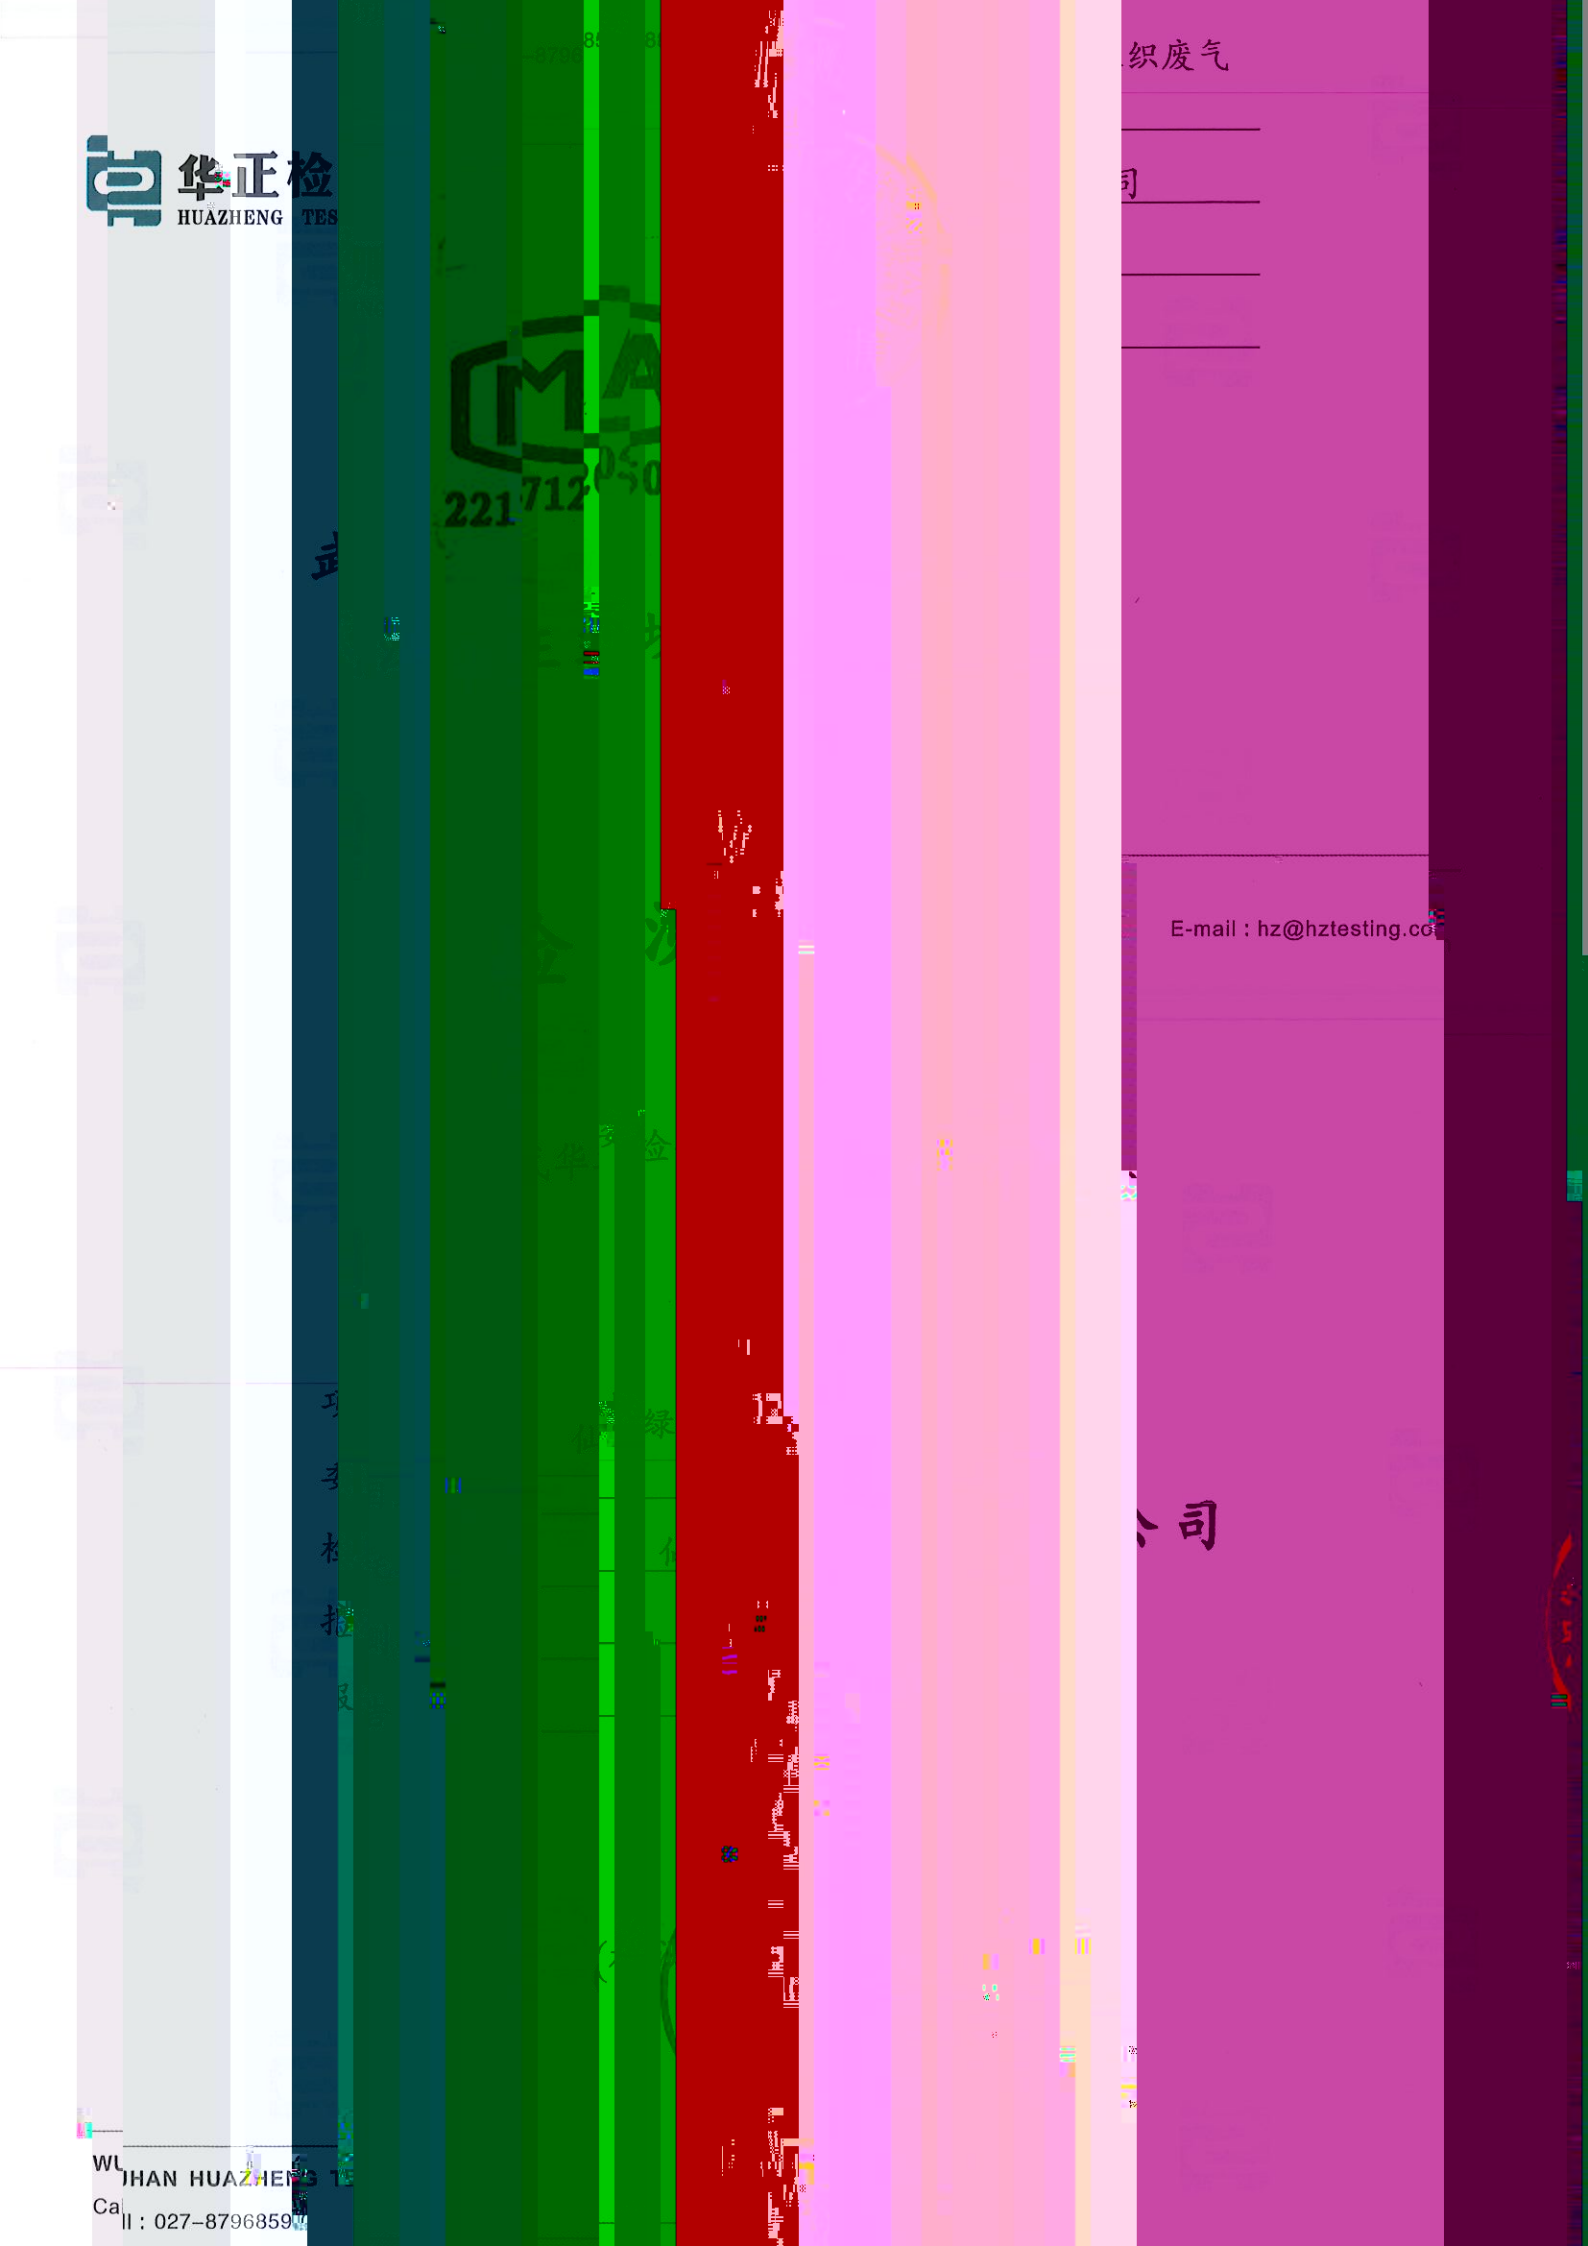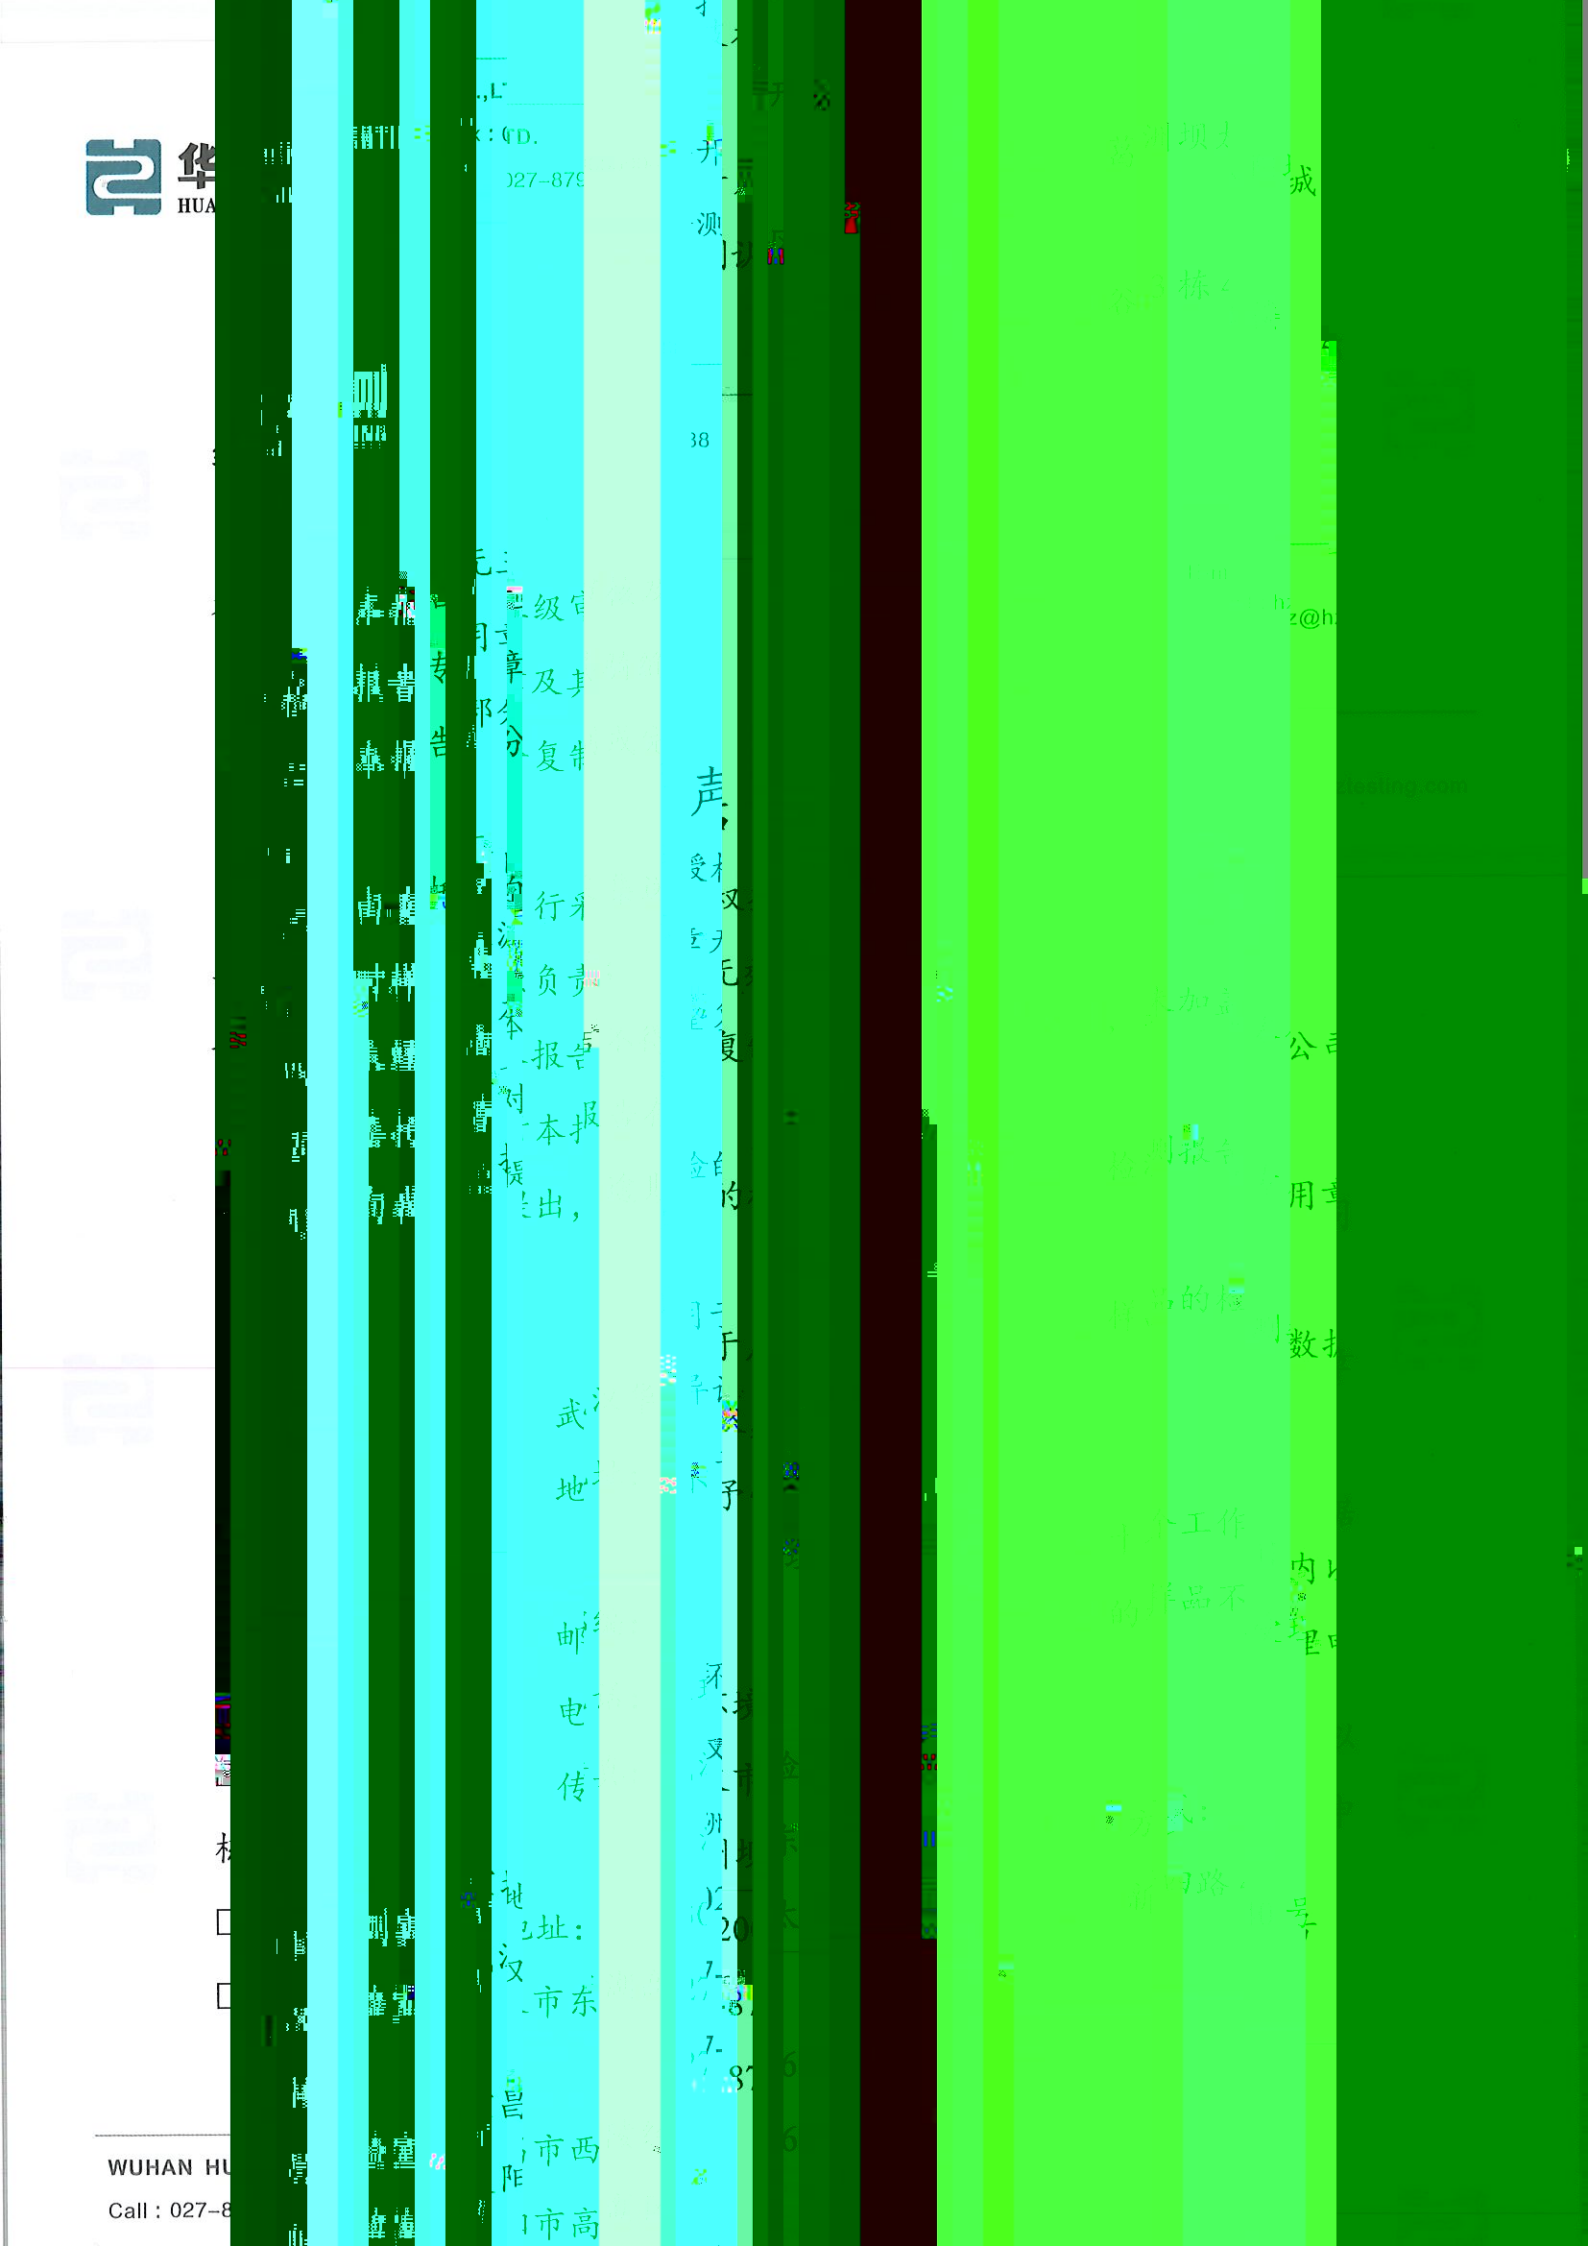

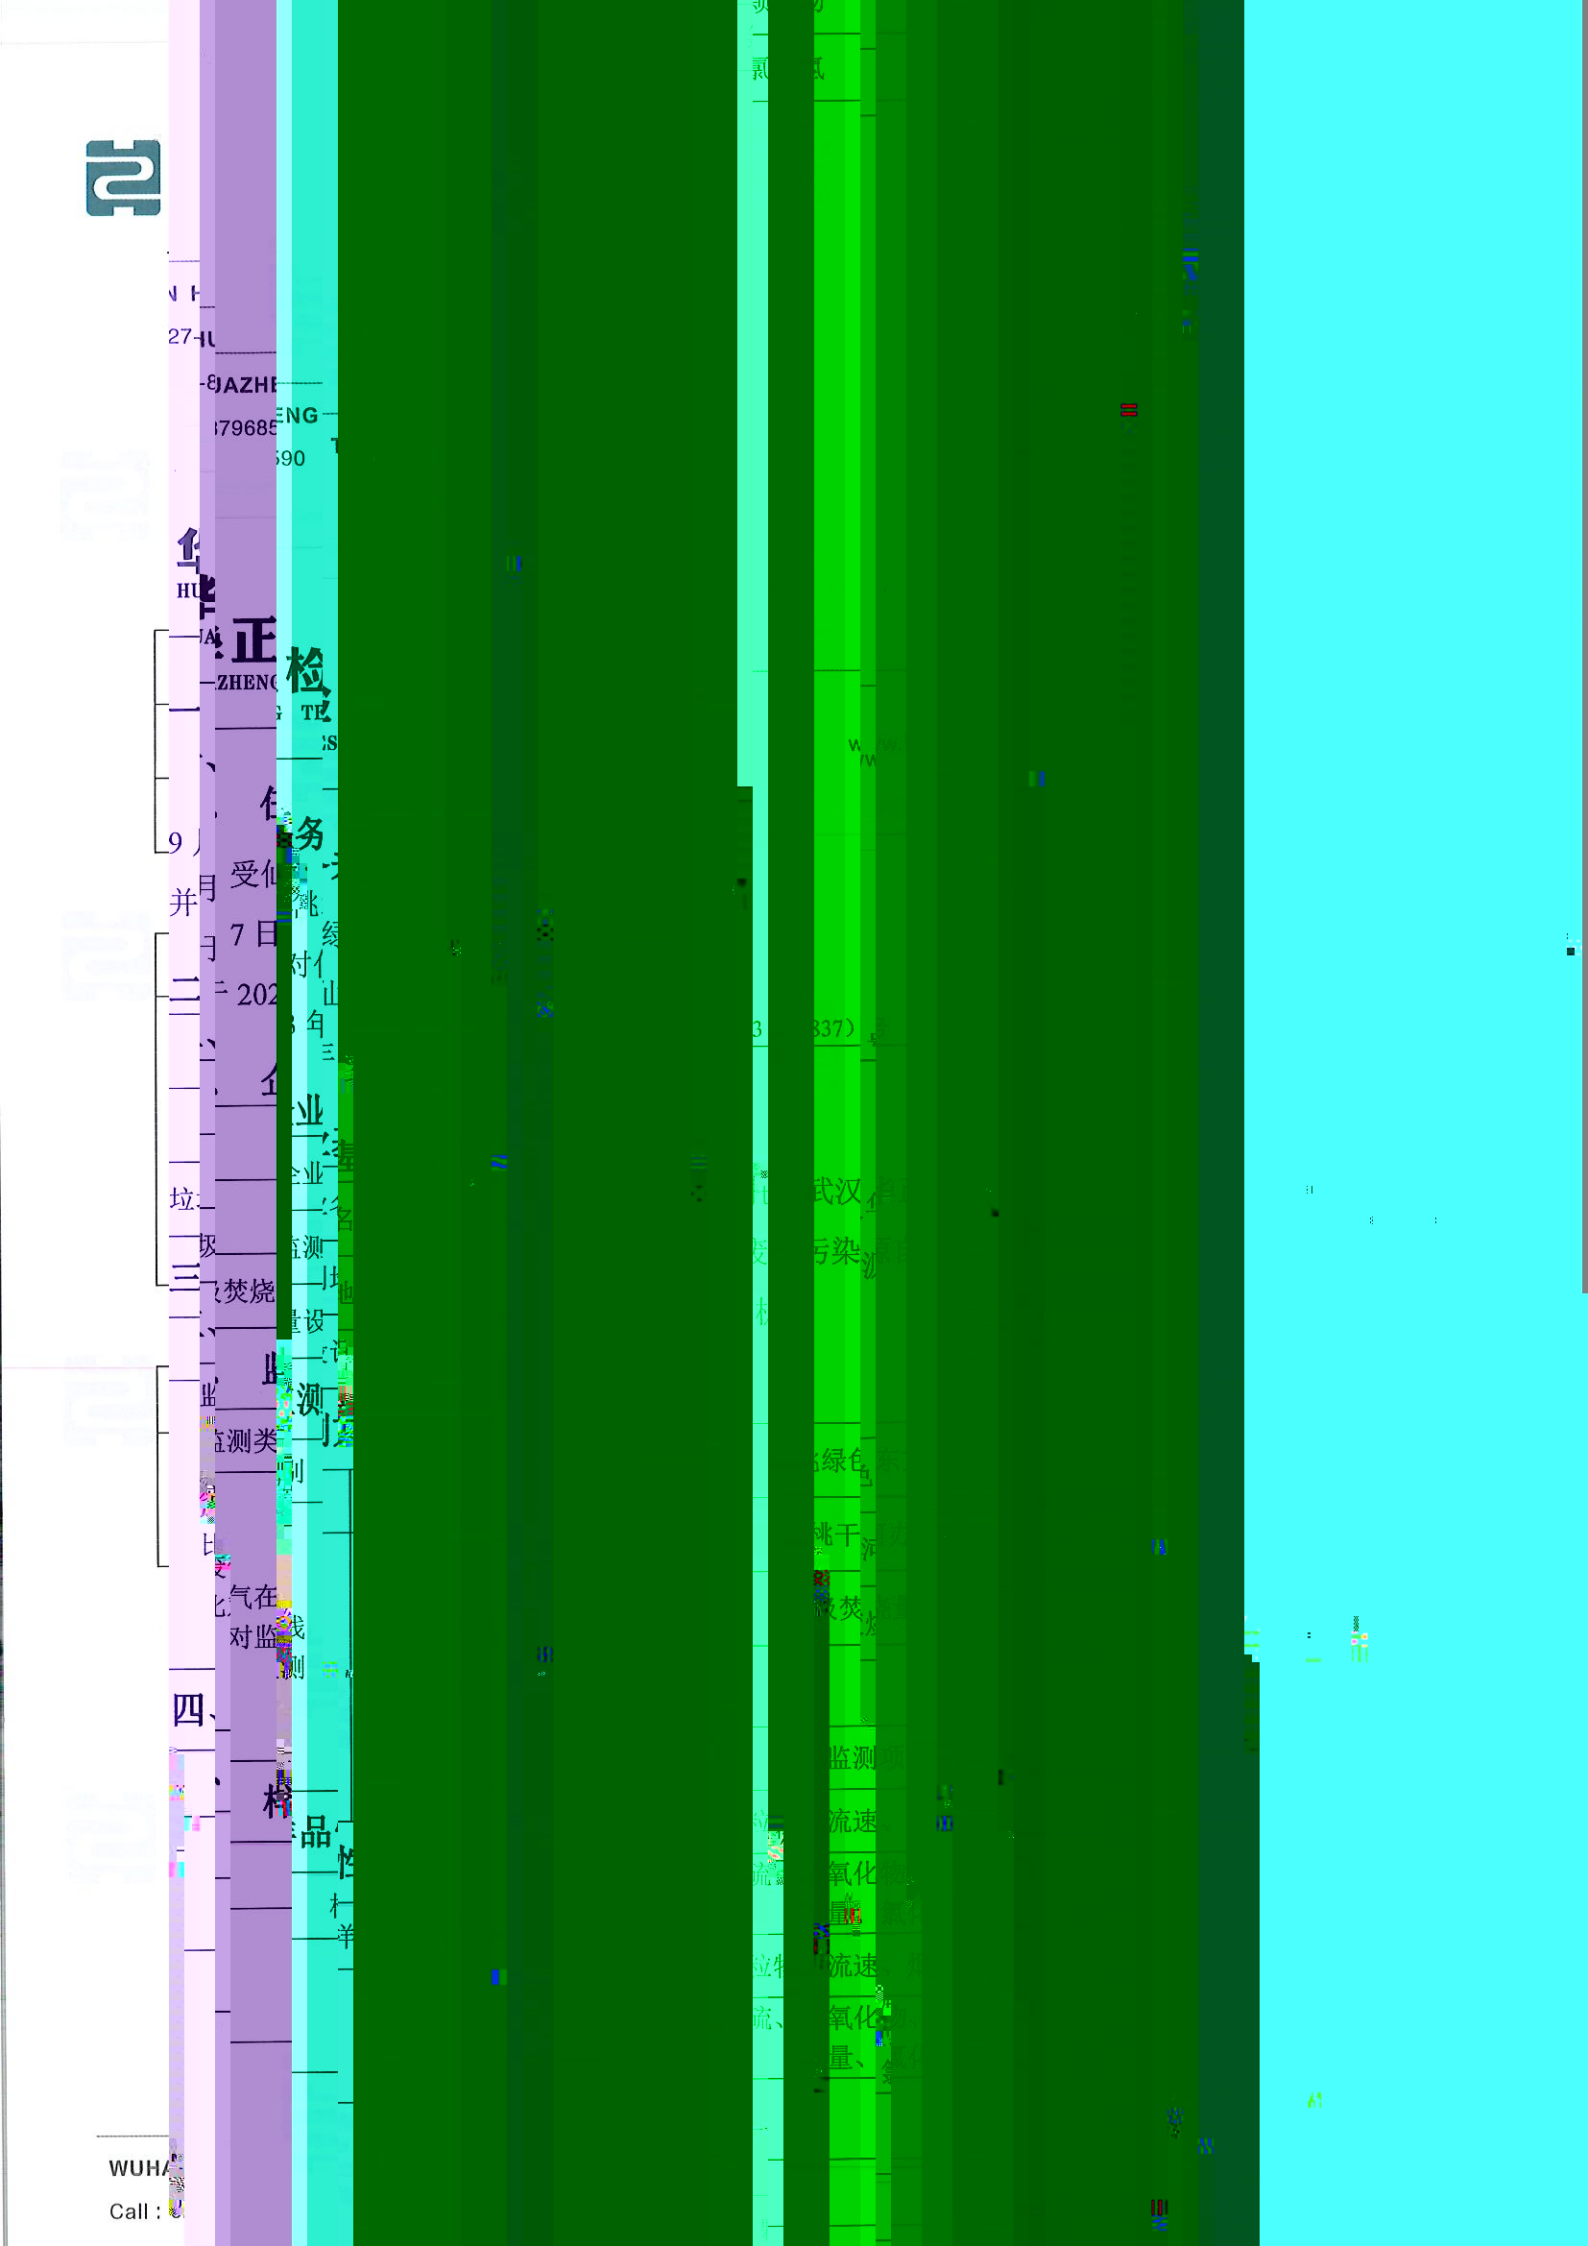

## 五、 检测

1、参比监

| 类别 | 监 |
| --- | --- |
| 废气 | 颗<br>流<br>温<br>二氧<br>氮氧<br>氧<br>一氧<br>氯 |

2、CEMS 法

| 类别 | 监 |
| --- | --- |
| 废气 | 颗<br><br><br><br>二<br>氮<br><br><br><br>氧 |

六、

(H

检测

和相

算的

七、

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颗 | | | | | | | | | | | |
| 二氧 | | | | | | | | | | | |
| 氮氧 | | | | | | | | | | | |
| 流 | | | | | | | | | | | |
| 烟 | | | | | | | | | | | |
| 氧 | | | | | | | | | | | |
| 湿 | | | | | | | | | | | |

要求及

3-2007）

数据计

维护。

$m^3$

$m^3$

华正
HUAZH

E-
mai

:hz@hztest ing.com

号）

技术要

第

（环办执

执行，执法

4页 共11页

具体

[2019]64

本准确度

一氧化

氯化氢

绝对误

差≤

，相对

mg/m³误差 20μmol/mo

）

≤30%

寸，相

24mg/m³对误

）

差≤30%

027-87968590

华正检
HUAZHENG TE

八、 比对

1-1、 污染源

| 监测点位 | | |
|---|---|---|
| DA002(2#排气筒)（◎1） | | |
| 比对监测结果 | | |
| DA003(1#排气筒)（◎2） | | |
| 比对监测结果 | | |

备注：排气筒高

| 颗粒物 | | |
|---|---|---|
| 参比方法 | | |
| 3.4 | | |
| 3.6 | | |
| 3.2 | | |
| 3.4 | | |
| -3. | | |
| 绝对误差 | | |
| 3.8 | | |
| 2.9 | | |
| 4.2 | | |
| .6 | | |
| -0. | | |
| 绝对误差 | | |

| | |
|---|---|
| 监 | |
| DA<br>气 | |
| 比 | |
| DA<br>气 | |
| 比 | |
| 备注 | |

WU
JHAN
Ca
l: 027-

华

HUAZ E


编号


2-1、污 点 流、参

项目

| 监测点 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA00 02( 排气筒 (◎1) | 4-16:0 | 1-16:2 | 2-16:5 | 9-17:24 | 0-17:45 | 6-18:1 | m³) | | | | | |
| 比对监测结果 | | | | | | | m³) | | | | | |
| DA00 03( 排气筒 (◎2) | 8-13:1 | 4-13:4 | 7-14:1 | -14:5 | -15:0 | -15:2 | ³) | | | | | |
| 比对监测结果 | | | | | | | m³) | | | | | |

备注：排

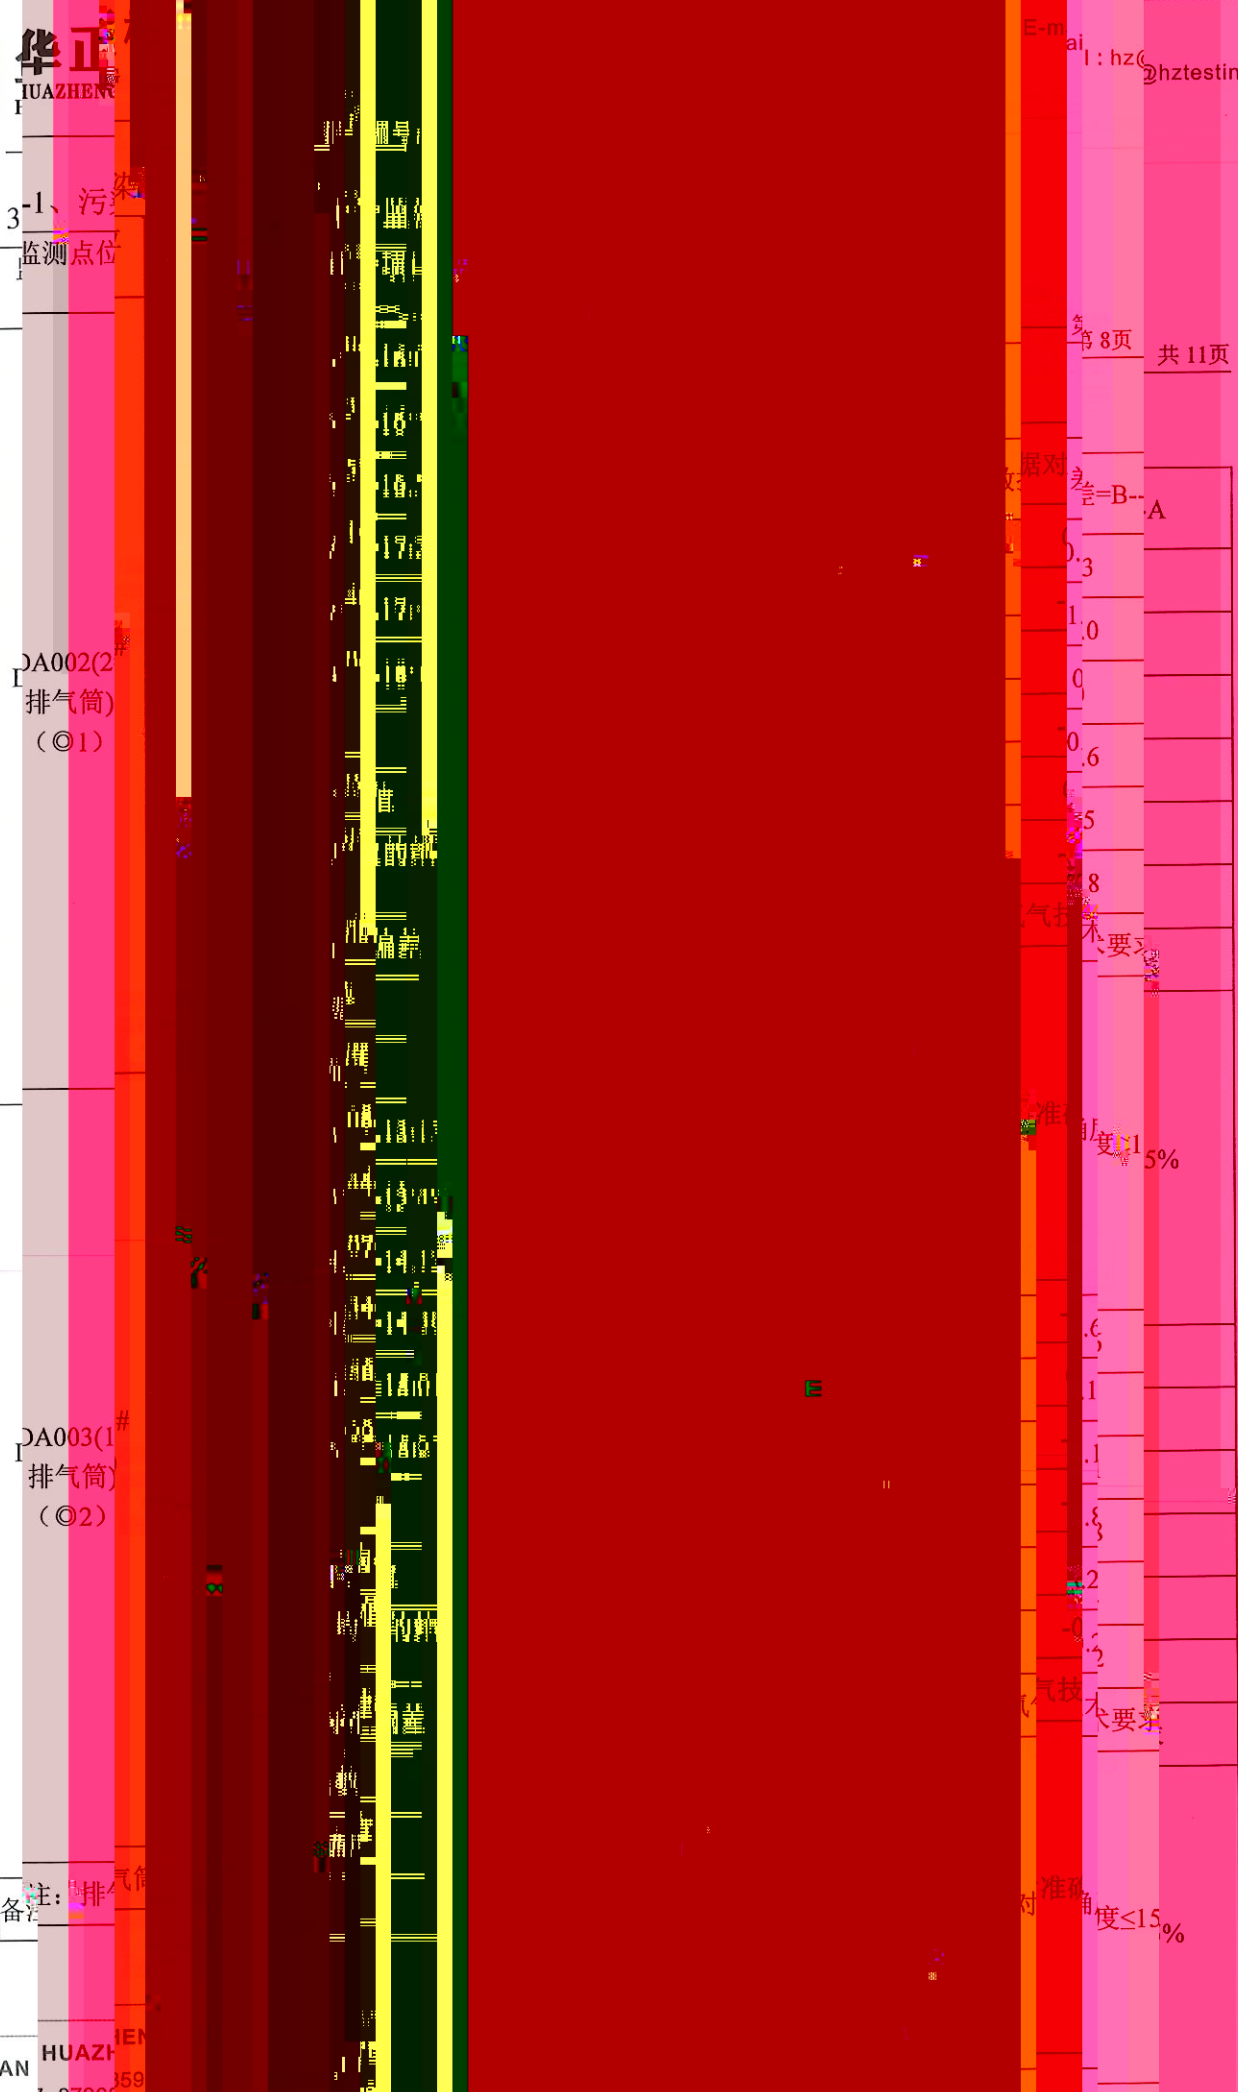
DA002(2#
排气筒)
（◎1）
DA003(1#
排气筒)
（◎2）

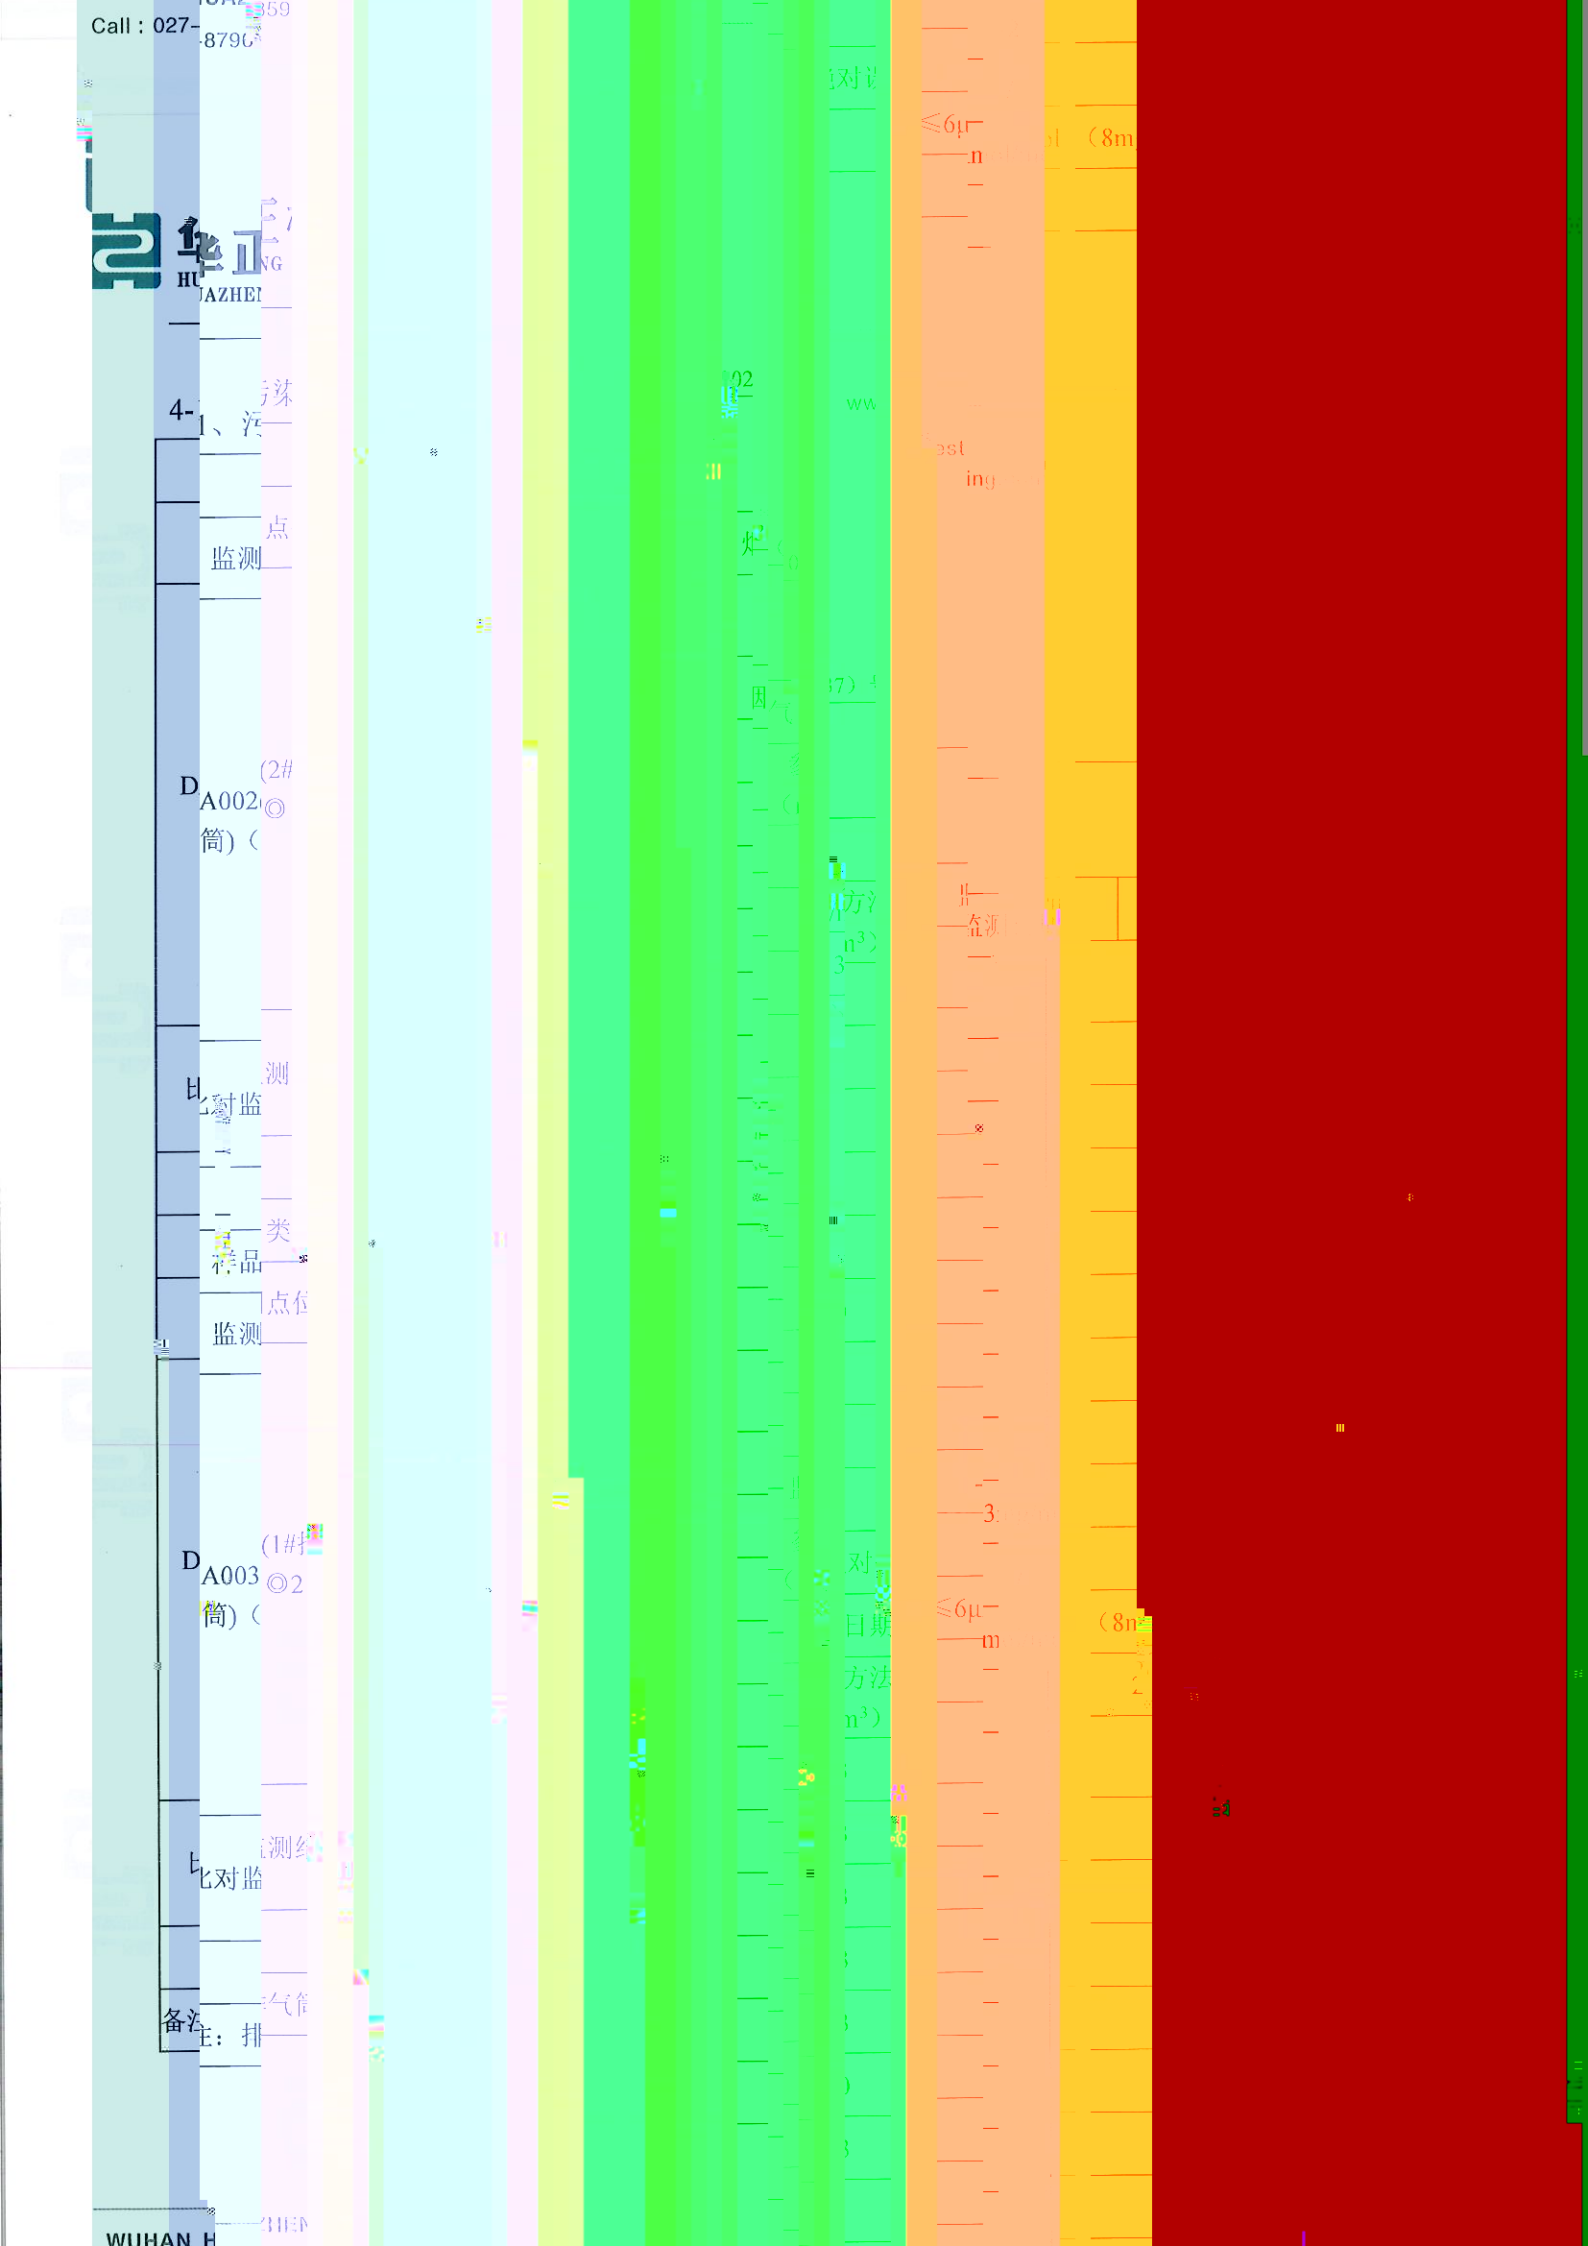

all：027-

-879

HU

JAZH

5-

1、污

监测

DA

筒00

门）（

比对

对监

样品

监测

DA

筒003

门）（

比对

对监

备注

：排

W

C

UHAN H